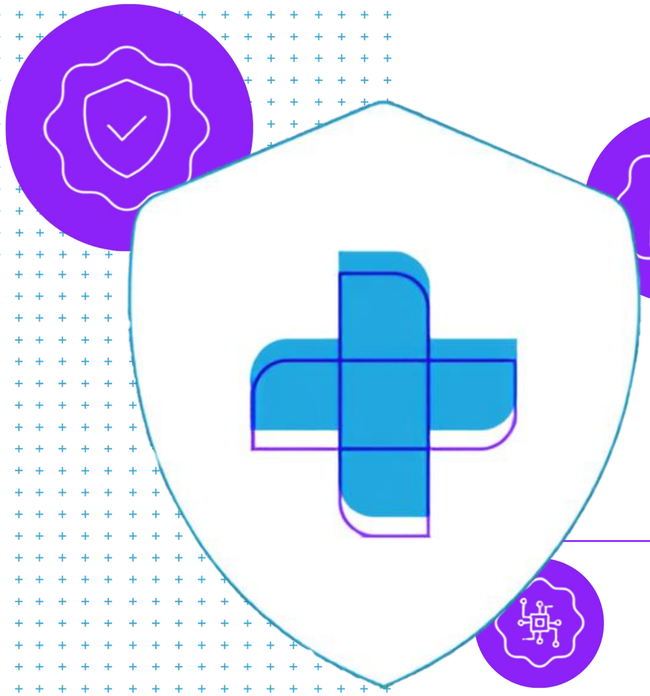


CATÁLOGO MEDICONE

Material destinado exclusivamente a Profissionais de Saúde.

medicone
Inovando para a Saúde

SUMÁRIO

ACESSO VASCULAR

Intromed Introdutor Standard 04
Cateter Central de Inserção Periférica PICC 05
Cateter Balão para Angioplastia Transluminal 06

ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares 08
Cateter Balão de Dilatação em Estágios 09
Fio Guia Não-Vascular Hidrofílico 10

TRATAMENTO PARA OBESIDADE

Balão Intragástrico Corprea 12
Cateter para Retirada de Balão Intragástrico 13

TERAPIA NUTRICIONAL

Sonda para Alimentação Enteral

Sonda para Alimentação Enteral 5000 16
Sonda para Alimentação Enteral 6000 17
Sonda para Alimentação Enteral 6010 18
Sonda para Alimentação Enteral 7000 19

Dispositivos para Gastrostomia

Sonda para Gastrostomia 21
Sonda para Gastrostomia M-Nutri com Conector Enfit 22
Kit Button para Gastrostomia M-Nutri MOD01 23
Kit Button para Gastrostomia M-Nutri MOD02 24
Sonda para Gastrostomia Endoscópica Percutânea 25

Bolsa para Nutrição Parenteral

Bolsa para Nutrição Parenteral Automática M-Nutri 27
Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional M-Nutri 28

PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA

Stent Y HCPA-1 30
Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios 31
Dreno Torácico de Silicone 32

CIRURGIA GERAL

Dreno Cirúrgico de Silicone 34
Tubo Hospitalar de Silicone 35

OTORRINOLARINGOLOGIA

Tubo de Ventilação 1021 Donaldson 37
Tubo de Ventilação 1063 Armstrong 38
Tubo de Ventilação 1092 Tipo "T" 39
Tubo de Ventilação 1026 Paparella 40
Tubo de Ventilação 1011 Shepard 41
Splint Intranasal com e sem Cânula 42
Tala Nasal 43

OFTALMOLOGIA

Banda e Trilho 45
Pneu 46
Tubo Lacrimal, Luva Sleeve e Esponja 47

ORTOPEDIA

Prótese de Tendão 49

UROLOGIA

Implante Testicular 51
Prótese Peniana 52
Tubo Hipospadia 53
Modelador Vesical 54

ACESSO VASCULAR



INTROMED INTRODUTOR STANDARD

Possui como princípio de funcionamento a geração de um canal de comunicação com o sistema vascular permitindo a introdução do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), destinado à administração intravenosa de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue para análise.

Características:

- Introdutor de agulha e cateter de polietileno;
- Agulha em aço inox;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	REFERÊNCIA COMERCIAL	DIÂMETRO EXTERNO DA AGULHA	DIÂMETRO PICC
94759	2 Fr Std	26 G	1.9 Fr
94761	3 Fr Std	19 G	2.8 Fr
94762	4 Fr Std	17 G	4.0 Fr
94763	5 Fr Std	15 G	5.0 Fr
94764	6 Fr Std	14 G	6.0 Fr



Nº Registro: 80020550053
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-026
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA PICC

Indicado para acesso venoso à circulação central para utilização em terapias intravenosas através da administração de medicamentos, dieta e coleta de material para análise. Possui como princípio de funcionamento a geração de um canal de comunicação direto até o sistema central vascular, de forma a permitir o uso das técnicas de terapia intravenosa.

Características:


- Fabricado em silicone implantável;
- Possui tubo branco e radiopaco;
- Contém marcações de posicionamento a cada centímetro;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
94778	Pediátrico	2.8 Fr	500 mm
94779	Adulto	3 Fr	650 mm
94780	Adulto	4 Fr	650 mm
94781	Adulto	5 Fr	650 mm
94782	Adulto	6 Fr	650 mm

O Kit contém:

A. Cateter Central de Inserção Periférica PICC mono lúmen;
B. Fita métrica;
C. Pinça;
D. Introdutor.

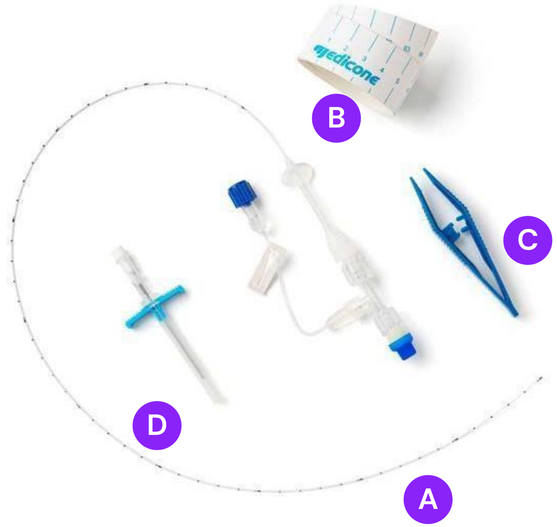


Nº Registro: 80020550045
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-033
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL

Utilizado na dilatação das artérias periféricas que podem estar obstruídas por placas de colesterol, coágulos de sangue ou até mesmo pela ocorrência da diminuição do diâmetro das artérias em decorrência do envelhecimento.

Características:

- O Cateter Balão para Angioplastia Transluminal Percutânea é comercializado unitariamente em embalagem primária de papel grau cirúrgico com laminado PET/ PE;
- O produto é composto por balão, tubo flexível, conector Y e duas marcas radiopacas;
- O cateter é acondicionado em uma cânula plástica protetora contra a compressão e danos externos;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

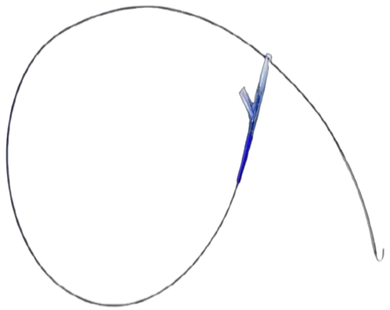

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	PRESSÃO RUPTURA
95466	PTAO 30040 L	3.0mm	40mm	16atm
94969	PTAO 30120 L	3.0mm	120mm	13atm
95467	PTAO 40040 L	4.0mm	40mm	14atm
95468	PTAO 40120 L	4.0mm	120mm	13atm
95469	PTAO 50040 L	5.0mm	40mm	14atm
95470	PTAO 50120 L	5.0mm	120mm	12atm
95471	PTAO 60040 L	6.0mm	40mm	14atm
94984	PTAO 60100 L	6.0mm	100mm	12atm
94985	PTAO 60120 L	6.0mm	120mm	12atm
95472	PTAO 70040 L	7.0mm	40mm	14atm
94987	PTAO 70100 L	7.0mm	100mm	12atm
95473	PTAO 70120 L	7.0mm	120mm	12atm
95474	PTAO 80080 L	8.0mm	80mm	11atm
94986	PTAO 80100 L	8.0mm	100mm	11atm
95475	PTAO 90080 L	9.0mm	80mm	11atm
95476	PTAO 10080 L	10.0mm	80mm	10atm
94968	PTAO 10120 L	10.0mm	120mm	10atm

Nº Registro: 80020559008
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-037
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/


ENDOSCOPIA DIGESTIVA



CATETER BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS BILIARES

O Cateter Balão para Extração de Cálculos Biliares Medicone consiste em um produto cujo o princípio de funcionamento baseia-se na sua capacidade de expansão controlada dentro das vias biliares, quando acoplado em um endoscópio flexível.

Um produto utilizado especificamente para remoção eficaz de cálculos no ducto biliar que são localizados nas vias e ductos biliares, abrangendo desde cálculos lamacentos até cálculos residuais que podem permanecer após procedimentos de litotripsia mecânica.

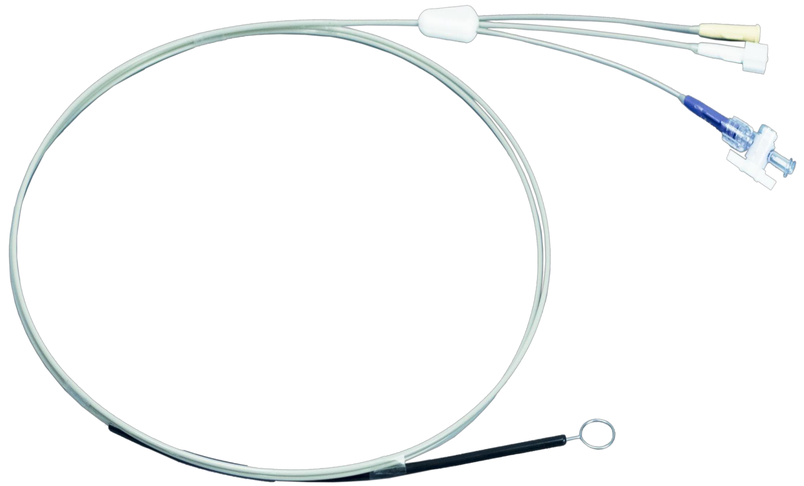

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
95637	23-12/15/18-B
95638	23-8.5/11.5/15-B
95639	23-10/13/16-B
95640	23-9/12/15-B
94970	23-15/18/20-B
95641	23-11/13/15-B


Nº Registro: 80020559010
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-042
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

CATETER BALÃO DE DILATAÇÃO EM ESTÁGIOS

O Cateter Balão de Dilatação em Estágios Medicone é usado para tratamento de dilatação ou como suporte para auxiliar na dilatação do trato digestivo.

O benefício clínico do Cateter Balão de Dilatação em Estágios Medicone é promover a dilatação de estenoses e auxiliar o paciente a voltar rapidamente às suas atividades diárias, livre do desconforto causado pela rigidez digestiva.

Além disso, o dispositivo pode ser utilizado como terapia auxiliar de dilatação, facilitando a realização de outros tratamentos ao paciente, como a colocação de stents.

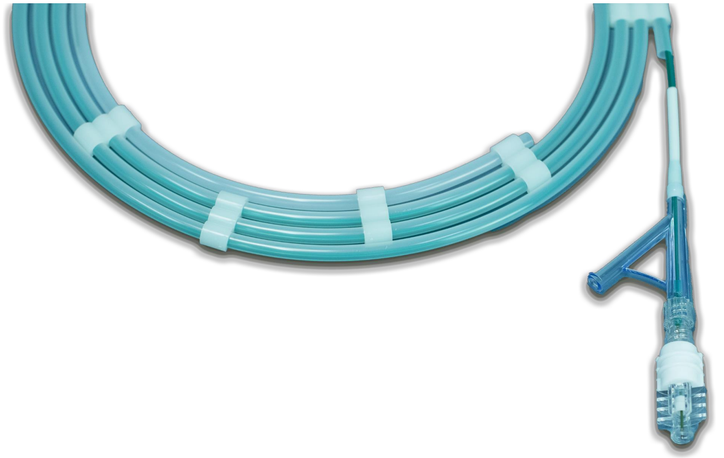

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
95658	10/11/12-40-200
95659	12/13.5/15-60-200
95660	15/16.5/18-60-230


Nº Registro: 80020559013
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-043
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

FIO GUIA NÃO-VASCULAR HIDROFÍLICO

O Fio Guia Não-Vascular Hidrofílico Medicone é um produto utilizado para auxiliar na introdução de dispositivos médicos, funcionando como trilho para a passagem de cateteres, endoscópios, dilatadores ou outros dispositivos médicos.

Possui baixo atrito, permitindo que deslize suavemente pelo lúmen anatômico sem causar trauma, facilitando a progressão em áreas curvas e estreitas, minimizando resistência e risco de perfuração.

Um dispositivo médico utilizado para auxiliar na introdução e posicionamento de instrumentos em procedimentos não-vasculares endoscópicos.

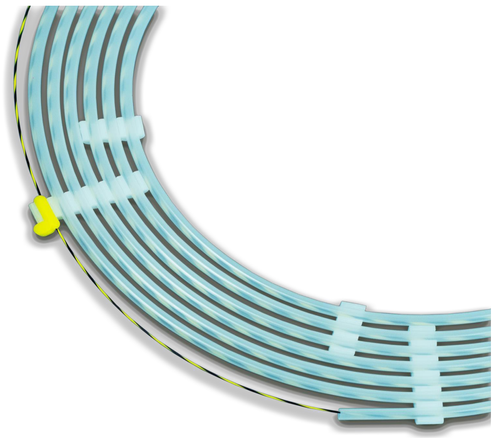

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
94988	ZGW-63-450-J
95642	ZGW-63-260-A
95643	ZGW-63-450-A
95644	ZGW-80-150-A
95645	ZGW-80-260-A
95646	ZGW-80-450-A
95647	ZGW-80-450-J
95648	ZGW-88-150-A
95649	ZGW-88-150-J
95650	ZGW-88-260-A
95651	ZGW-88-450-A
95652	ZGW-88-450-J
95653	ZGW-88-460-A
95654	ZGW-63-150-A
95655	ZGW-63-150-J
95656	ZGW-80-150-J
95657	ZGW-88-180-J

Nº Registro: 80020559012
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-041
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TRATAMENTO PARA OBESIDADE




BALÃO INTRAGÁSTRICO CORPOREA

O Balão Intragástrico Corporea é um dispositivo endoscópico temporário, utilizado para o tratamento de controle de peso em pessoas com obesidade ou sobrepeso. Disponível para utilização de 6 ou 12 meses, a depender do tratamento indicado.

Características:

- Durante o processo de endoscopia o Balão Intragástrico Corporea é preenchido por solução salina e azul de metileno. O volume do balão será de 400mL a 700mL;
- É produzido em silicone grau médico, resistentes ao contato com o suco gástrico;
- Fornecido vazio, acondicionado em membrana de contenção e fixado ao tubo de condução e preenchimento, permitindo sua introdução via endoscópica.

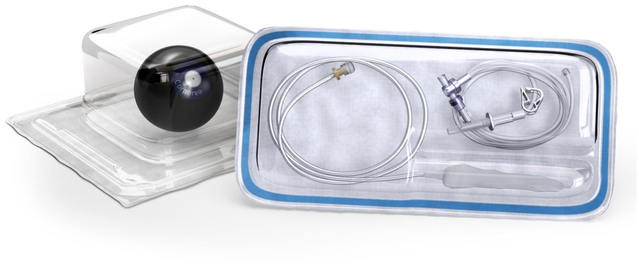



DISPONÍVEL NAS VERSÕES:


CÓDIGO	MODELO
94601	Balão Intragástrico Estéril
94693	Balão Intragástrico Corporea 6 Meses – Não Estéril
94908	Balão Intragástrico Corporea 12 Meses

Nº Registro: 80020550042/80020550044/80020550068
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-036/FT-MED-023/FT-MED-001
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

CATÉTER PARA RETIRADA DE BALÃO INTRAGÁSTRICO

A Medicone dispõe de três tipos de cateteres para retirada de balão intragástrico:

AGULHA

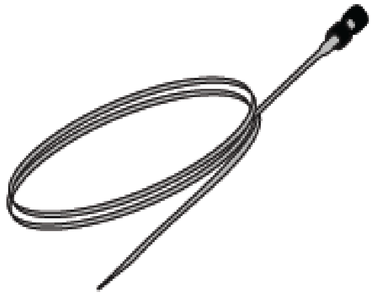

PINÇA



ALÇA



DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
94897	Cateter para Retirada de Balão Intragástrico – Tipo Agulha
94889	Cateter para Retirada de Balão Intragástrico – Tipo Pinça
94898	Cateter para Retirada de Balão Intragástrico – Tipo Alça

Nº Registro: 80020550071/80020559005/80020550072
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-031/FT-MED-032/FT-MED-030
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TERAPIA NUTRICIONAL



SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 5000 POLIURETANO

Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunais em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.

Características:

- Constituída por tubo 100% Poliuretano branco radiopaco;
- Facilitado visualização no Raio-x;
- Conector proximal lilás em dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente;
- Com encaixe em todos os tipos de equipamentos para alimentação enteral;
- Fio guia de inserção AISI304. Fornecido já lubrificado;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Graduação ao longo do tubo

GRADUAÇÃO AO LONGO DO TUBO:
Para indicar posição da ponteira no momento da introdução e auxiliar na avaliação de possíveis deslocamentos.

PONTEIRA DISTAL DE PESO:
Obtida pela adição de Tungstênio em pó ao Poliuretano, facilitando migração e sustentação no estômago/duodeno.

PONTEIRA DISTAL COM ORIFÍCIOS LATERAIS:
A ponteira distal possui sua ponta aberta e tem dois orifícios laterais, desencontrados.

FIO GUIA DE INSERÇÃO:
Fabricado em aço inoxidável lubrificado.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO/COMPRIMENTO
94971	Pediátrica	06Fr / 60 cm
94972	Infantil	08Fr / 60 cm
94973	Adulto	08Fr / 105 cm
94974	Adulto	10Fr / 105 cm
94975	Adulto	12Fr / 120 cm

Nº Registro: 80020550040
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-019
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 6000 SILICONE


Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunais em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.

Características:

- Fabricada em Silicone e possui tubo radiopaco com 05 (cinco) marcações de posicionamento;
- Possui conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente a todos os equipos de alimentação enteral. Na extremidade oposta ao conector possui ponteira distal de silicone sem peso e o tubo possui orifícios.
- Fio guia de inserção fornecido lubrificado a base de silicone;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO/COMPRIMENTO
95601	Pediátrica	06Fr / 60 cm
95602	Infantil	08 Fr /60 cm

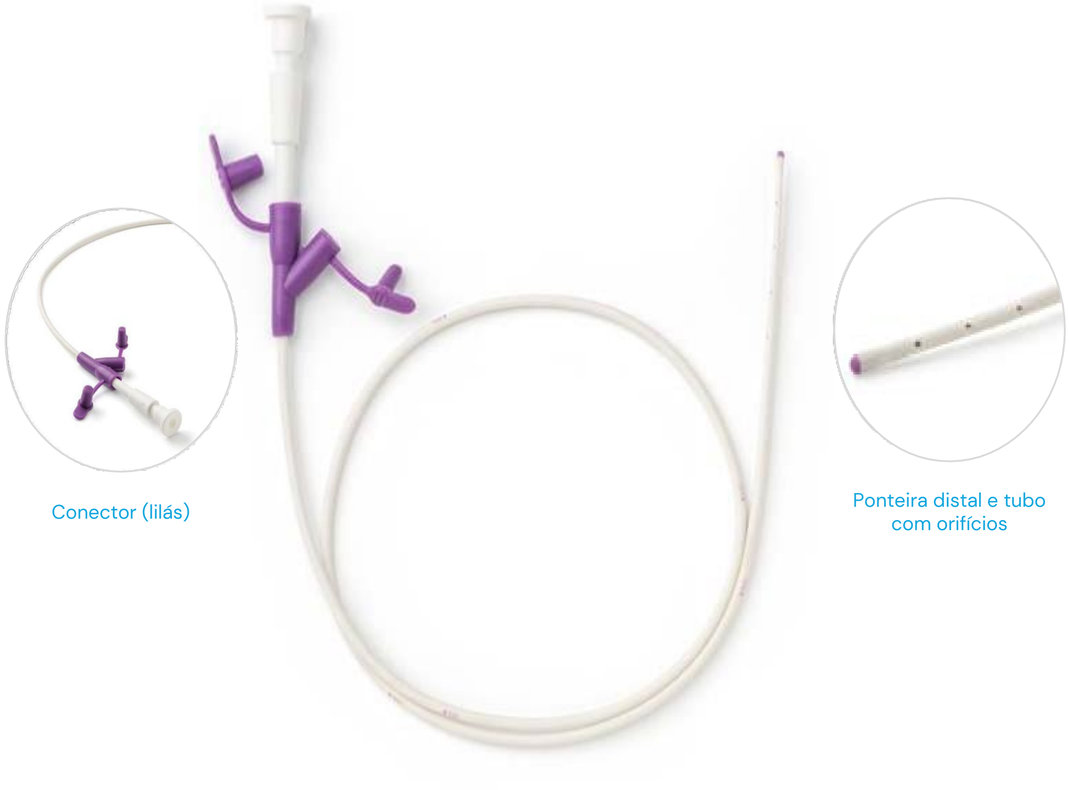

Conector (lilás)

Ponteira distal e tubo com orifícios

Nº Registro: 80020550062
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-018
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 6010 SILICONE

Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunal em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por meio tradicional.

Características:

- Fabricada em Silicone e possui tubo radiopaco com 05 (cinco) marcações de posicionamento;
- Possui conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente a todos os equipos de alimentação enteral. Na extremidade oposta ao conector o tubo possui orifícios.
- Fio guia de inserção fornecido lubrificado a base de silicone;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Conector (lilás)

Tubo com orifícios

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO/COMPRIMENTO
95600	Neonatal	05 Fr / 40 cm

Nº Registro: 80020559003
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-022
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 7000 SILICONE


Indicado para administração de dietas gástricas, enterais e/ou jejunais em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral.

Características:

- Constituída por tubo de silicone transparente com tarja radiopaca lilás;
- Possui conector proximal de silicone na cor lilás com dupla derivação (formato Y) que se ajusta facilmente a todos os tipos de equipo de alimentação enteral;
- Ponteira distal de silicone com peso, obtido pela adição de Tungstênio em pó ao silicone para facilitar a migração e sua sustentação no estômago/duodeno;
- Fio guia de inserção fabricado em aço inox AISI 304 e fornecido lubrificado a base de silicone;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO/COMPRIMENTO
94894	Adulto	08 Fr / 1050 mm
94895	Adulto	10 Fr / 1050 mm
94896	Adulto	12 Fr / 1200 mm

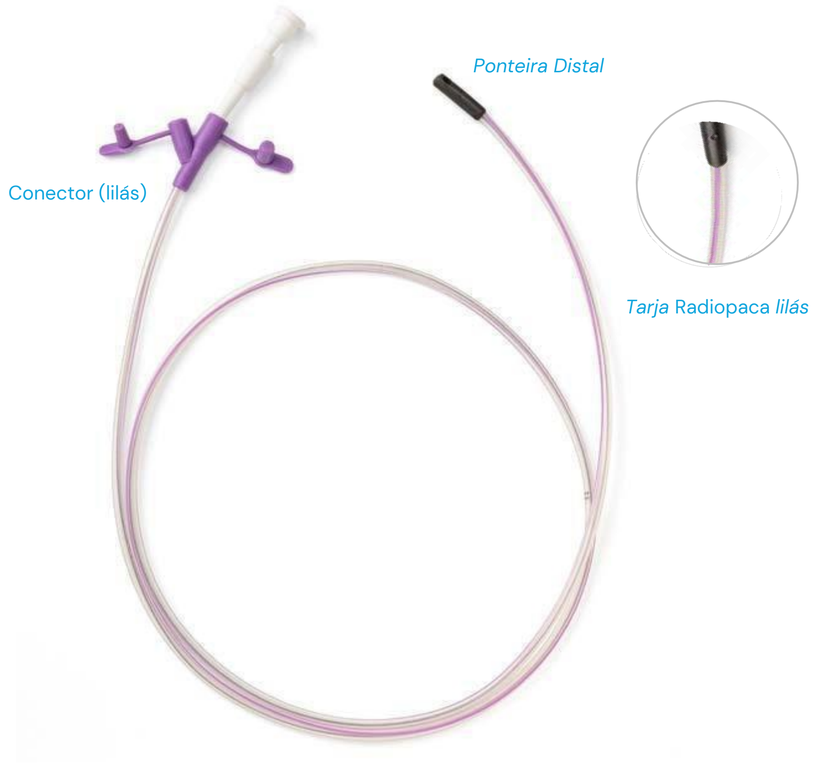

Nº Registro: 80020550065
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-017
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/


DISPOSITIVOS PARA GASTROSTOMIA

SONDA PARA GASTROSTOMIA

Indicado para administração de dietas em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral. O produto possui como princípio de funcionamento a geração da comunicação externa até o estômago do paciente, de forma a permitir a administração de dietas e medicamentos. Destina-se a pacientes com fístula gastrocutânea pré-existente ou criada durante um procedimento Stamm ou Witzel.

Características:

- Composta por tubo de silicone grau farma translúcido com linha radiopaca azul, com ponteira distal com balão e conector proximal com tripla derivação:
  - ✓ Administração de dieta;
  - ✓ Administração de medicamentos;
  - ✓ Válvula para insuflação do balão, com cor diferenciada.
- Possui marcações indicando o tamanho e a capacidade máxima do balão;
- Possui marcações que indicam o posicionamento em 2, 4 e 6 cm;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

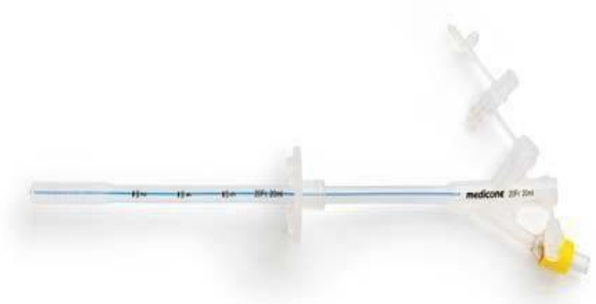

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	VOLUME	COR DO CONECTOR
94585	12 Fr	5 mL	Branco
94586	14 Fr	5 mL	Verde
94733	16 Fr	5 mL	Laranja
94588	18 Fr	20 mL	Vermelho
94589	20 Fr	20 mL	Amarelo
94590	22 Fr	20 mL	Roxo
94591	24 Fr	20 mL	Azul



Tripla Derivação

Nº Registro: 80020550047
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-015
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

SONDA PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI COM CONECTOR- ENFIT

Indicado para administração de dietas em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por via oral. O produto possui como princípio de funcionamento a geração da comunicação externa até o estômago do paciente, de forma a permitir a administração de dietas e medicamentos. Destina-se a pacientes com fístula gastrocutânea pré-existente ou criada durante um procedimento Stamm ou Witzel.

Características:

- Fabricado em silicone, possui uma ponteira com balão e conector proximal com tripla derivação;
- Administração de dieta;
- Administração de medicamentos;
- Válvula para insuflação do balão, com cor diferenciada.
- Possui marcações indicando o tamanho e a capacidade máxima do balão;
- Possui marcações que indicam o posicionamento em 2, 4 e 6 cm;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	VOLUME	COR DO CONECTOR
95477	12 Fr	5 mL	Branco
95478	14 Fr	5 mL	Verde
95479	16 Fr	5 mL	Laranja
95480	18 Fr	20 mL	Vermelho
95481	20 Fr	20 mL	Amarelo
95482	22 Fr	20 mL	Roxo
95483	24 Fr	20 mL	Azul



Tripla Derivação

Nº Registro: 80020559009
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-038
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI


Sua indicação de uso destina-se a pacientes que foram submetidos à gastrostomia endoscópica percutânea, para alimentação por períodos extensos, havendo então a necessidade de trocas da sonda ao longo da vida. Também são utilizadas para descompressão gástrica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94910	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 14Fr 1,0cm
94913	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 14Fr 2,0cm
94917	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 16Fr 1,5cm
94919	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 16Fr 2,0cm
94923	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 18Fr 1,5cm
94925	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 18Fr 2,0cm
94930	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 1,0cm
94932	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 1,5cm
94933	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 1,7cm
94934	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 2,0cm
94936	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 2,5cm
94938	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 3,0cm
94939	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 3,5cm
94940	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 4,0cm
94941	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 20Fr 4,5cm
94948	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 24Fr 1,7cm
94943	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 24Fr 2,0cm
94945	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 24Fr 2,5cm
94946	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 24Fr 3,0cm
94949	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED01 - 24Fr 3,5cm

Nº Registro: 80020550059
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-025
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

MODELO 01 – MED01


O KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI MODELO 1 – MED01 é composto por:

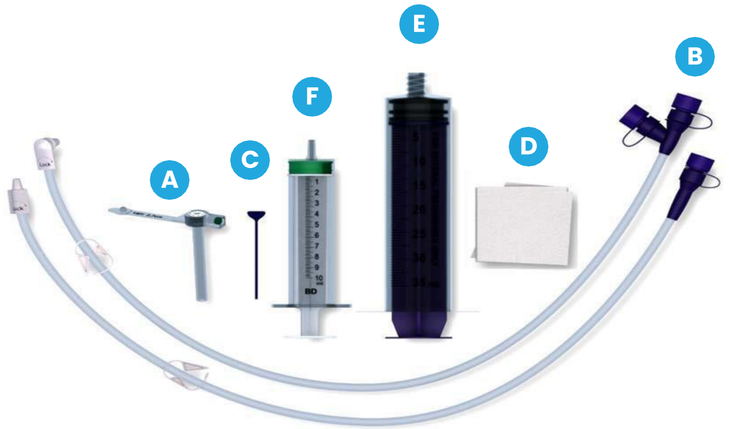

Item	Descrição	Qtde
A	Button para Gastrostomia	01
B	Extensor Enfit	02
C	Introdutor	01
D	Gaze	02
E	Seringa Luer Slip 10mL	01
F	Seringa Enfit 35mL	01


A BUTTON GASTROSTOMIA

Parte	Descrição
1	Eixo (Tubo)
2	Corpo do Button
3	Válvula bico-de-pato
4	Anel conector
5	Balão
6	Válvula de retenção

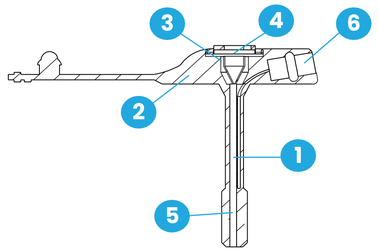

B EXTENSORES (ACESSÓRIOS)

Parte	Descrição
1A	Conector Unidirecional Enfit
1B	Conector 2 Vias Enfit
2	Tubo
3C	Conector Reto
3D	Conector Ângulo Reto
4	Clamp

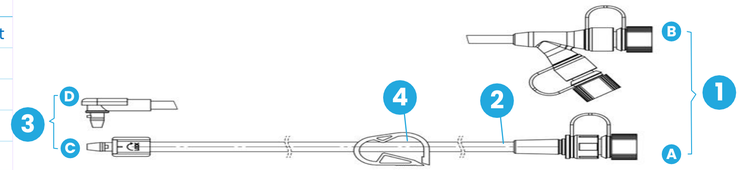

KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI

Sua indicação de uso destina-se a pacientes que foram submetidos à gastrostomia endoscópica percutânea, para alimentação por períodos extensos, havendo então a necessidade de trocas da sonda ao longo da vida. Também são utilizadas para descompressão gástrica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95715	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 14Fr 1,0cm
95718	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 14Fr 2,0cm
95722	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 16Fr 1,5cm
95724	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 16Fr 2,0cm
95728	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 18Fr 1,5cm
95730	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 18Fr 2,0cm
95735	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 1,0cm
95737	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 1,5cm
95738	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 1,7cm
95739	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 2,0cm
95741	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 2,5cm
95743	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri – MED02 - 20Fr 3,0cm
95744	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 3,5cm
95745	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 4,0cm
95746	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 20Fr 4,5cm
95596	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02- 24Fr 1,7cm
95748	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 24Fr 2,0cm
95750	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 24Fr 2,5cm
95751	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 24Fr 3,0cm
95597	Kit Button para Gastrostomia M-Nutri - MED02 - 24Fr 3,5cm

MODELO 02 – MED02


O KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI MODELO 2 – MED02 é composto por:



Item	Descrição	Qtde
A	Button para Gastrostomia	01
B	Extensor	02
C	Introdutor	01
D	Gaze	02
E	Seringa Luer Slip 10mL	01
F	Seringa Enfit 35mL	01
G	Adaptador de Transição escalonado Enfit	01


A BUTTON GASTROSTOMIA

Parte	Descrição
1	Eixo (Tubo)
2	Corpo do Button
3	Válvula bico-de-pato
4	Anel conector
5	Balão
6	Válvula de retenção

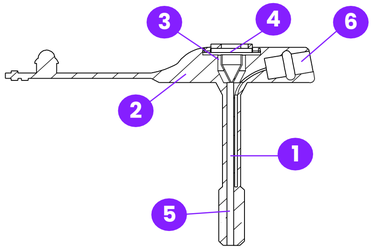

B EXTENSORES (ACESSÓRIOS)

Parte	Descrição
1A	Conector Unidirecional
1B	Conector 2 Vias
2	Tubo
3C	Conector Reto
3D	Conector Ângulo Reto
4	Clamp

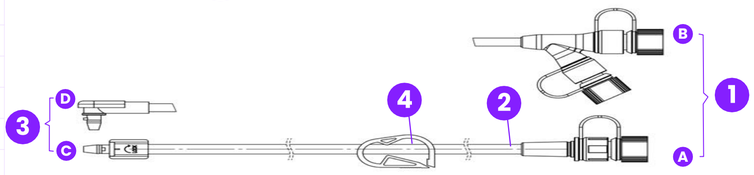

Nº Registro: 80020550059
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-025
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

SONDA PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA

A Sonda para Gastrostomia Endoscópica Percutânea M-Nutri consiste em um tubo de colocação inicial destinado à nutrição enteral. É indicada para pacientes que por alguma razão necessitam complementar ou substituir totalmente a alimentação por via oral. O dispositivo é inserido no estômago do paciente durante o procedimento de gastrostomia endoscópica percutânea.

Características:

- Possui um tubo de silicone translúcido, com linha radiopaca;
- Possui ponteira;
- Possui retentor interno flexível. O retentor interno tem a função de fixar a sonda no interior do estômago, prevenindo a sua saída ou remoção acidental. Além disso, o retentor também funciona com um tampão que impede o extravasamento da dieta e de secreções gástricas pelo estoma.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95547	PEG – 12 Fr
95548	PEG – 18 Fr
95549	PEG – 22 Fr
95550	PEG – 14 Fr
95551	PEG – 16 Fr
95552	PEG – 20 Fr
95553	PEG – 24 Fr

A SONDA PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA (PEG-PULL) M-NUTRI é composta por:

- ✓ Sonda para gastrostomia;
- ✓ Adaptadores de duas vias;
- ✓ Anel para fixação externa;
- ✓ Alça de apreensão;
- ✓ Gazes;
- ✓ Compressas;
- ✓ Fio de inserção;
- ✓ Clamp;
- ✓ Bisturi;
- ✓ Seringa;
- ✓ Agulha introdutora (cânula);
- ✓ Agulhas;
- ✓ Campo cirúrgico fenestrado;
- ✓ Pinça hemostática.










Nº Registro: 80020550061
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-004
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

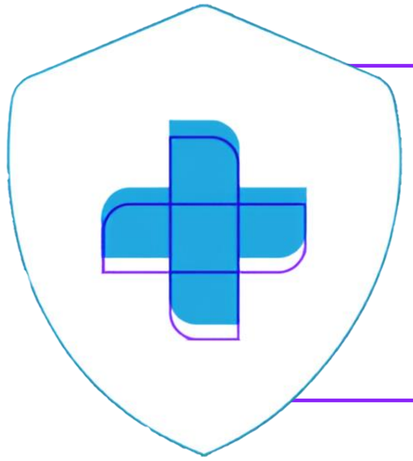

BOLSAS PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL

BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL M-NUTRI

É indicada para manipulação, conservação, transporte e administração de nutrição parenteral em pacientes hospitalizados. A Bolsa para Nutrição Parenteral Gravitacional utiliza como princípio de funcionamento o escoamento gravitacional da nutrição parenteral.

Características:

- Transparência: Permite cuidadosa inspeção visual antes do uso.
- Flexibilidade: Colapsidade completa, permitindo administração total do seu conteúdo sem a necessidade de entrada de ar.
- Ausência de Plastificante: Não há contaminação da nutrição parenteral, por migração de plastificantes, apresenta baixo nível de substâncias extraíveis.
- Ausência de Absorção de Drogas: Permite a administração ao paciente da quantidade exata de drogas adicionada a solução parenteral.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95612	150ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95613	300ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95614	500ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95615	1000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
95616	2000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI
956157	3000ML COM CONECTOR MACHO M-NUTRI



Nº Registro: 80020550075
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-002
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL AUTOMÁTICA M-NUTRI


É indicada para manipulação, conservação, transporte e administração de nutrição parenteral em pacientes hospitalizados. Seu princípio de funcionamento permite que o preenchimento das nutrições parenterais ocorra através de uma ponteira (ponto de injeção), que serve como conector acoplado à bolsa, e pode ser utilizada para técnicas tanto automáticas como manuais.

Características:

- Transparência: Permite cuidadosa inspeção visual antes do uso.
- Flexibilidade: Colapsidade completa, permitindo administração total do seu conteúdo sem a necessidade de entrada de ar.
- Ausência de Plastificante: Não há contaminação da nutrição parenteral, por migração de plastificantes, apresenta baixo nível de substâncias extraíveis.
- Ausência de Absorção de Drogas: Permite a administração ao paciente da quantidade exata de drogas adicionada a solução parenteral.
- Excelente Inércia química: Compatível com os componentes das NP, inclusive lipídeos. A inércia é uma característica das poliolefinas (polietileno e polipropileno) daí sua vantagem como matéria-prima para recipientes de bolsa para nutrição parenteral.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95607	BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL AUTOMÁTICA 500 ML M-NUTRI
95608	BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL AUTOMÁTICA 500 ML M-NUTRI
95609	BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL AUTOMÁTICA 1000 ML M-NUTRI
95610	BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL AUTOMÁTICA 2000 ML M-NUTRI
95611	BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL AUTOMÁTICA 3000 ML M-NUTR

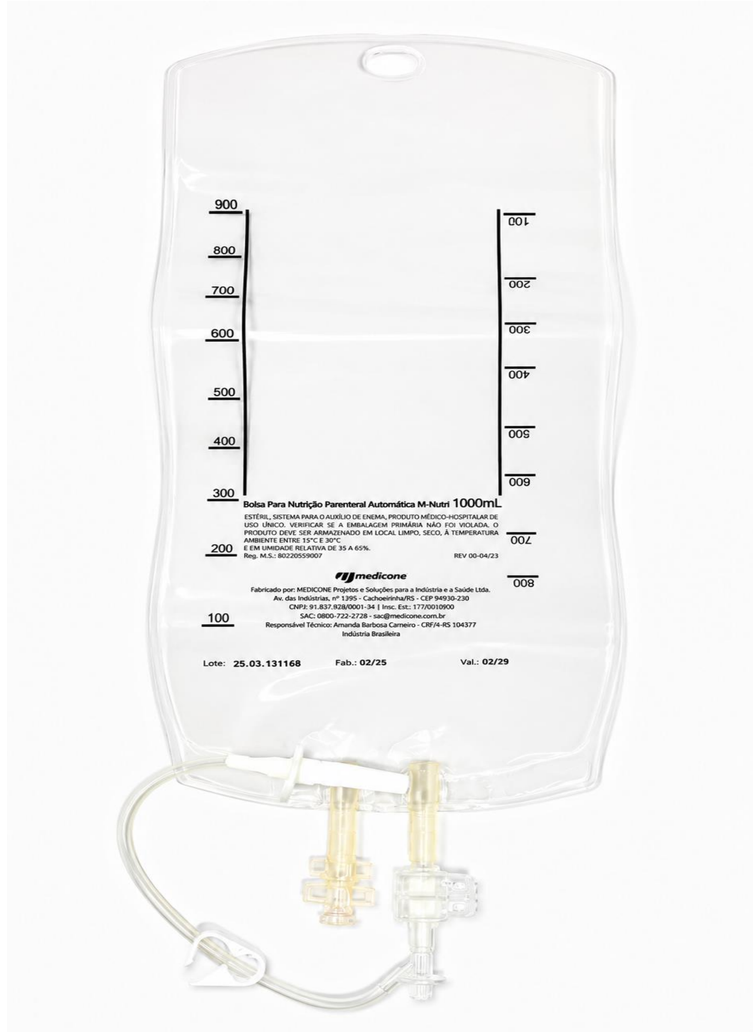

Nº Registro: 80020559007
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-003
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA



STENT Y HCPA-1

O Stent Y HCPA-1 é indicado no tratamento das estenoses em vias aéreas em que haja a contra indicação quanto ao tratamento cirúrgico.

Alguns exemplos de indicações potenciais para o emprego do Stent Y HCPA-1 são:

- Obstrução neoplásica pela compressão extrínseca das vias aéreas centrais em pacientes que já realizaram ou estão com os tratamentos primariamente indicados (carcinoma de pulmão, tireoide, esôfago) em progresso;
- Obstrução neoplásica intrínseca em tratamento de desobstrução com laser e dilatação;
- Obstrução neoplásica maligna em pacientes tratados com radioterapia externa;
- Estenose subglótica pós-intubação após tratamento com laser ou dilatação.



DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	MODELO
94699	STENT Y HCPA-1 SY16.50.13.35.25 REF. SY16.17

Nº Registro: 80020550058
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-013
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

STENT ÓRTESE PARA TRAQUEIA E BRONQUIOS

O Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios foi desenvolvido para tratamento das estenoses em vias aéreas em que haja a contraindicação de procedimentos cirúrgicos.

O produto poderá ser implantado por período indeterminado, sendo que o tempo de permanência no paciente deverá ser determinado pelo médico.

Características:

- Produto fabricado em silicone implantável, pigmentado na cor branca e radiopaco, devido a adição do Sulfato de Bário.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
94175	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC0930
94176	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC0950
94177	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1130
94178	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1150
94179	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1330
94180	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1350
94181	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1430
94182	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1450
94183	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1650
94184	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1670
94185	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1850
94186	Stent Medicone Órtese para Traqueia e Brônquios - Ref. SC1870

Nº Registro: 80020550058
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-013
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

DRENO TORÁCICO DE SILICONE

Utilizado em cirurgias de tórax e cardíacas bem como em urgências emergenciais quando da presença de trauma em caixa torácica. Tem o objetivo de remover líquidos e gases, facilitando a re-expansão do pulmão e restabelecendo a função cardiorrespiratória normal.

Características:

- Fabricado em silicone grau farmacêutico, trazendo benefícios em relação à outros tipos de materiais;
- Possui linha radiopaca branca em toda sua extensão para identificação nos exames de Raio-X;
- Em uma das suas extremidades, possui orifícios para facilitar a drenagem.
- É fornecido com um conector plástico universal e ajustável ao diâmetro do dreno;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Linha Radiopaca Branca

Apresentam o comprimento de 50 cm e diâmetros que variam de:

- 08 Fr a 18 Fr: Possui dureza de 80 Shore A;
- 20 Fr a 40 Fr: Possui dureza de 70 Shore A.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94000	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 08 FR
94001	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 10 FR
94002	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 12 FR
94003	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 14 FR
94004	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 16 FR
94005	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 18 FR
94083	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 20 FR
94084	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 22 FR
94085	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 24 FR
94086	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 26 FR
94087	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 28 FR
94088	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 30 FR
94089	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 32 FR
94090	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 34 FR
94091	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 36 FR
94092	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 38 FR
94093	DRENO TORÁCICO DE SILICONE 40 FR

Nº Registro: 80020550017
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-028
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

CIRURGIA GERAL




DRENO CIRÚRGICO DE SILICONE

Destina-se ao uso de drenagem geral cirúrgica, tais como: drenagem mediastinal, drenagem de secreções pós-operatórias, drenagem em cirurgia bariátrica e drenagem em cirurgia plástica.

Características:

- Fabricado em silicone grau farmacêutico;
- Tubo transparente, flexível, hipoalergênico, biocompatível e de alta resistência;
- Possui linha radiopaca branca em toda sua extensão para identificação nos exames de Raio-X;
- Possui grau de assepsia superior à de outros materiais.
- Sua parte interna tem um desenho corrugado que permite excelente drenagem, evitando o colabamento e interrupção da drenagem;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

O dreno está disponível nos comprimentos de 30, 40 e 50 cm nos diâmetros apresentados abaixo:



DIÂMETRO
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm



Linha Radiopaca Branca

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
94017	DRENO CIRÚRGICO Ø 06 X 300MM
94018	DRENO CIRÚRGICO Ø 08 X 300MM
94019	DRENO CIRÚRGICO Ø 10 X 300MM
94020	DRENO CIRÚRGICO Ø 12 X 300 MM
94040	DRENO CIRÚRGICO Ø 12 X 500 MM
94041	DRENO CIRÚRGICO Ø 10 X 400 MM
94042	DRENO CIRÚRGICO Ø 12 X 400 MM
94046	DRENO CIRÚRGICO Ø 06 X 400 MM
94047	DRENO CIRÚRGICO Ø 08 X 400 MM
94049	DRENO CIRÚRGICO Ø 06 X 500 MM
94050	DRENO CIRÚRGICO Ø 08 X 500 MM
94051	DRENO CIRÚRGICO Ø 10 X 500 MM

Nº Registro: 80020550033
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-029
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TUBO HOSPITALAR DE SILICONE

Destina-se ao uso geral ambulatorial e cirúrgico hospitalar, como auxiliar na condição e eliminação de líquidos, gases e fluídos. Em geral, são acoplados ou conectados a equipamentos existentes, sendo que os comprimentos devem ser ajustados de acordo com as necessidades de cada uso devido às diversas disposições.

Características:

- Tubo transparente e flexível;
- Fabricado em silicone grau farmacêutico;
- Possui grau de assepsia superior à de outros materiais;
- Produto não estéril;
- Pode ser esterilizado em ETO (óxido de etileno) ou autoclave (vapor úmido sob pressão), utilizando embalagem adequada.



DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS Ø
94301	Tubo de Silicone 120	0,59 x 0,99 mm
94302	Tubo de Silicone 125	0,64 x 1,19 mm
94303	Tubo de Silicone 130	0,76 x 1,65 mm
94304	Tubo de Silicone 140	1,02 x 2,16 mm
94305	Tubo de Silicone 158	1,05 x 1,97 mm
94306	Tubo de Silicone 162	1,5 x 2,42 mm
94307	Tubo de Silicone 178	1,98 x 3,18 mm
94308	Tubo de Silicone 180	2 x 4 mm
94309	Tubo de Silicone 200	3 x 5 mm
94310	Tubo de Silicone 201	4 x 8 mm
94311	Tubo de Silicone 202	5 x 10 mm
94312	Tubo de Silicone 203	6 x 10 mm
94313	Tubo de Silicone 204	6 x 12 mm
94314	Tubo de Silicone 205	8 x 11,5 mm
94315	Tubo de Silicone 206	8 x 12,8 mm
94316	Tubo de Silicone 207	8 x 14 mm
94317	Tubo de Silicone 208	9,5 x 14,6 mm
94318	Tubo de Silicone 210	12 x 16,5 mm
94334	Tubo de Silicone Oxigênio Frisado	6 x 10 mm
94359	Tubo de Silicone Lipo	9,5 x 17 mm

Comprimento padrão do rolo: 15 metros.

Nº Registro: 80020550031
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-005
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

OTORRINOLARINGOLOGIA



TUBO DE VENTILAÇÃO 1021 DONALDSON

Utilizados no mau funcionamento da Tuba Auditiva, que tem como função manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar secreções e estabelecer a comunicação com o ouvido médio e a rinofaringe, quando a mesma não responde à terapia convencional (medicamentos).

Características:

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta flexibilidade;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Possui o formato de “carretel” vazado com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94142	TUBO DE VENTILAÇÃO MEDICONE 1021 – DONALDSON



1021 DONALDSON

Nº Registro: 80020550030
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-009
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TUBO DE VENTILAÇÃO 1063 ARMSTRONG

Utilizados no mau funcionamento da Tuba Auditiva, que tem como função manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar secreções e estabelecer a comunicação com o ouvido médio e a rinofaringe, quando a mesma não responde à terapia convencional (medicamentos).

Características:

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta resistência;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Tem o formato de um "carretel" vazado com flange somente em uma lateral para fixação na membrana do tímpano.;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94144	TUBO DE VENTILAÇÃO MEDICONE 1063 ARMSTRONG



1063 ARMSTRONG

Nº Registro: 80020550019
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-008
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TUBO DE VENTILAÇÃO 1092 TIPO “T”

Utilizados no mau funcionamento da Tuba Auditiva, que tem como função manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar secreções e estabelecer a comunicação com o ouvido médio e a rinofaringe, quando a mesma não responde à terapia convencional (medicamentos).

Características:

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta resistência;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato em “T” vazado com flange somente em uma lateral para fixação na membrana do tímpano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94145	TUBO DE VENTILAÇÃO MEDICONE 1092 – TIPO T



1092 TIPO “T”

Nº Registro: 80020550020
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-011
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TUBO DE VENTILAÇÃO 1026 PAPARELLA

Utilizados no mau funcionamento da Tuba Auditiva, que tem como função manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar secreções e estabelecer a comunicação com o ouvido médio e a rinofaringe, quando a mesma não responde à terapia convencional (medicamentos).

Características:

- Confeccionado em silicone e pigmentado na cor azul;
- Possui alta resistência;
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato de “carretel” vazado com flanges laterais de tamanhos diferenciados para fixação na membrana do tímpano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94143	TUBO DE VENTILAÇÃO MEDICONE 1026 PARARELLA



1026 PAPARELLA

Nº Registro: 80020550021
Referências: Instrução de Uso (IFU) e 1026/05
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TUBO DE VENTILAÇÃO 1011 SHEPARD

Utilizados no mau funcionamento da Tuba Auditiva, que tem como função manter a pressão do ouvido médio igual à atmosférica, drenar secreções e estabelecer a comunicação com o ouvido médio e a rinofaringe, quando a mesma não responde à terapia convencional (medicamentos).

Características:

- Confeccionado em (Teflon) na cor branca (cor natural);
- Material atóxico e apirogênico, não irrita nem provoca reações alérgicas;
- Apresenta formato de "carretel" vazado com flanges laterais de igual tamanho para fixação na membrana do tímpano;
- Possui sua apresentação com e sem haste de aço inox;
- A identificação do produto se dá pela indicação das letras SH – Sem Haste e CH – Com Haste;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94139	PRÓTESE TUBO DE VENTILACAO 1011 - SHEPARD C/HASTE
94140	PRÓTESE TUBO DE VENTILACAO 1011 - SHEPARD S/HASTE



1011 SHEPARD

Nº Registro: 80020550022
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-010
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

SPLINT INTRANASAL COM OU SEM CÂNULA

É destinado a pacientes que realizaram cirurgias (reparadoras ou estéticas) de nariz.

Características:

- Promove a sustentação da cartilagem septo nasal;
- Possibilita a respiração nasal em pós-operatório imediato e em casos de sangramento pós-cirúrgico, não obstruindo o fluxo de ar;
- Previne aderências intranasais, onde há o risco do tecido da cicatriz nasal obstruir a cavidade nasal;
- Produto de fácil higienização;
- Fabricado em silicone biocompatível, flexível e translúcido;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

COM CÂNULA | DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	COMPRIMENTO	LARGURA
94980	68 mm	23 mm

SEM CÂNULA | DISPONÍVEL NA VERSÃO:

CÓDIGO	COMPRIMENTO	LARGURA
94981	72 mm	24 mm



Splint Intranasal com Cânula



Splint Intranasal sem Cânula

Nº Registro: 80020550064
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-014
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TALA NASAL


A Tala Nasal Medicone é um produto utilizado para a imobilização e estabilização do nariz no pós- operatório de intervenções cirúrgicas como rinoplastia, septoplastia, reparos de fraturas nasais e procedimentos relacionados à sinusite.

É adequada para pacientes adultos e pediátricos, adaptando-se às necessidades individuais de cada caso cirúrgico.

Um produto estéril, flexível e termomoldável, sendo composto por polímero termomoldável em policaprolactona (PCL) e uma interface autoadesiva à base de polímero acrílico.

A Tala Nasal Medicone é de uso único e foi projetada para a estabilização eficaz do dorso nasal externo, sendo essencial após uma variedade de intervenções cirúrgicas no nariz.

A utilização da Tala Nasal Medicone minimiza o risco de deslocamento ósseo e contribui para um processo de cicatrização após procedimento cirúrgico, mais eficaz e confortável para o paciente.

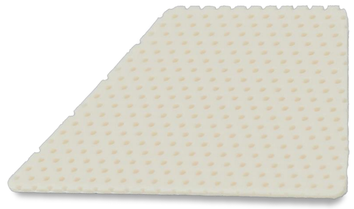

Tala Nasal MEDO1



Tala Nasal MEDO2

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
95627	MED 01 - P - MARROM
95628	MED 01 - P - ROSA
95629	MED 01 - P - BRANCA
95630	MED 01 - M - MARROM
95631	MED 01 - M - ROSA
95632	MED 01 - M - BRANCA
95633	MED 01 - G - MARROM
95634	MED 01 - G - ROSA
95635	MED 01 - G - BRANCA
95618	MED 02 - P - MARROM
95619	MED 02 - P - ROSA
95620	MED 02 - P - BRANCA
95621	MED 02 - M - MARROM
95622	MED 02 - M - ROSA
95623	MED 02 - M - BRANCA
95624	MED 02 - G - MARROM
95625	MED 02 - G - ROSA
95626	MED 02 - G - BRANCA

Nº Registro: 80020550076
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-040
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

OFTALMOLOGIA



IMPLANTE OFTALMOLÓGICO
BANDA E TRILHO

Utilizados em cirurgias de descolamento de retina e em alguns casos em vitrectomia.

Sendo:

→ **Banda: Para a fixação do Trilho ou Pneu;**


→ **Trilho: Desenvolvido para aumentar a ação da Banda e facilitar a fixação.**

Características:

- Fabricados em silicone implantável;
- O implante é feito em caráter permanente;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Implante Oftalmológico Banda

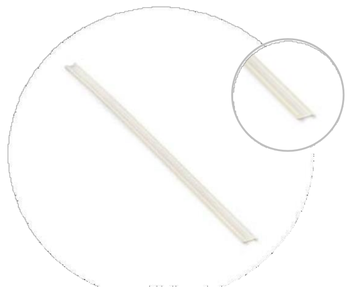

Implante Oftalmológico Trilho

BANDA | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	LARGURA (A)	ALTURA (B)	COMPRIMENTO
94100		2 mm	0,75 mm	125 mm
94101		3,5 mm	0,75 mm	125 mm
94102		4 mm	1,25 mm	125 mm
94103		2,5 mm	0,6 mm	125 mm

TRILHO | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	LARGURA (A)	ALTURA (B)	VÃO (C)	COMPRIMENTO
94137		4,5 mm	1,25 mm	2,5 mm	125 mm
94138		6 mm	1,5 mm	2,5 mm	125 mm
94136		5 mm	2,5 mm	2 mm	125 mm

Nº Registro: 80020550013
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-035
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

IMPLANTE OFTALMOLÓGICO
PNEU

Indicado para cirurgia de descolamento de retina e alguns casos de vitrectomia.





Características:

- Fabricados em silicone implantável;
- O implante é feito em caráter permanente;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Implante Oftalmológico Pneu

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO		LARGURA SUPERIOR (A)	LARGURA INFERIOR (B)	VÃO (C)	DIAMETRO EXTERNO
94131	Assimétrico Côncavo ou Côncavo Interno		7 mm	9 mm	2,5 mm	31,7 mm
94132	Simétrico Côncavo ou Côncavo Interno		7 mm	9 mm	2,5 mm	31,7 mm
94133	Simétrico Côncavo ou Côncavo Interno		9 mm	11 mm	2,5 mm	31,7 mm
94134	Assimétrico Côncavo ou Côncavo Interno		10 mm	12 mm	2,5 mm	31,7 mm
94135	Biconvexo ou Convexo Interno		7 mm	9 mm	2,5 mm	31,7 mm

Nº Registro: 80020550014
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-024
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

IMPLANTE OFTALMOLÓGICO
TUBO LACRIMAL, LUVA SLEEVE E ESPONJA

Indicado para cirurgia de descolamento de retina e alguns casos de vitrectomia.


→ **O Tubo Lacrimal** serve para a reconstituição do canal lacrimal;

→ **A Luva Sleeve** serve para fixação da banda quando feita a introflexão;

→ **A Esponja** é utilizada para introflexão escleral conforme técnica e preferência do cirurgião.

Características:

- Fabricados em silicone implantável;
- O implante é feito em caráter permanente;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

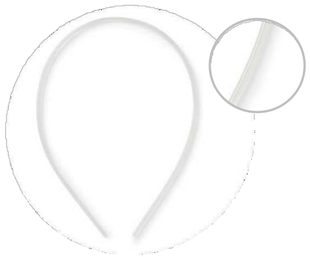

Tubo Lacrimal



Luva Sleeve



Esponja

TUBO LACRIMAL | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	LARGURA (A)	ALTURA (B)	COMPRIMENTO
94148		0,6 mm	0,9 mm	125 mm e 500 mm
94147		0,3 mm	0,7 mm	125 mm e 500 mm

LUVA SLEEVE | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
94156		1,6 mm	2,4 mm	125 mm
94146		1 mm	2,1 mm	125 mm
94149		0,75 mm	1,65 mm	125 mm

ESPONJA | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
94123		3 mm	80 mm
94124		4 mm	80 mm

Nº Registro: 80020550015
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-006
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

ORTOPEDIA



PRÓTESE DE TENDÃO


Utilizada como implante temporário para a formação do espaço e posterior reconstrução do tendão de flexão ou extensão da mão. A prótese é fixada ao coto do tendão remanescente por meio de suturas, conforme técnica e procedimento cirúrgico adequado.

Características:

- Confeccionada em silicone grau implantável;
- Possui superfície lisa;
- Possui contraste radiopaco;
- Disponível em dois modelos: oval e cilíndrico, ambos com comprimento de 30 cm;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Prótese de Tendão




Ponta Oval



Ponta Cilíndrica

PRÓTESE DE TENDÃO OVAL | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MEDIDA A	MEDIDA B	COMPRIMENTO
94111	2 mm	1 mm	30 cm
94112	3 mm	1,5 mm	30 cm
94113	4 mm	2 mm	30 cm
94114	5 mm	2,5 mm	30 cm
94115	6 mm	3 mm	30 cm
94116	7 mm	3,5 mm	30 cm



PRÓTESE DE TENDÃO CILÍNDRICO | DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
94104	1 mm	30 cm
94105	2 mm	30 cm
94106	3 mm	30 cm
94107	4 mm	30 cm
94108	5 mm	30 cm
94109	6 mm	30 cm
94110	7 mm	30 cm



Nº Registro: 80020550018
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-020
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

UROLOGIA



IMPLANTE TESTICULAR

Desenvolvido para complemento ou correção estética em pacientes que tiveram perda, má formação, ausência ou moléstia do testículo natural.

Características:

- Constituído por casulo de silicone grau médico, químico e mecanicamente resistente;
- Contém volume definido de gel de silicone altamente coesivo;
- Produto desenvolvido de modo que sua forma, densidade e consistência global sejam similares ao tecido humano;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO	LARGURA X ALTURA	VOLUME
94192	P	18 x 25 mm	5 mL
94193	M	26 x 34 mm	10 mL
94194	G	31 x 44 mm	20 mL
94195	GG	33 x 48 mm	30 mL



1st *Maior Segurança ao Paciente*

Nº Registro: 80020550043
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-027
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

PRÓTESE PENIANA


Desenvolvida para auxiliar no tratamento de problemas com ereção masculina. Utiliza como princípio de funcionamento a diminuição do volume dos corpos cavernosos do pênis, através da inserção do implante, proporcionando ao organismo uma área menor para irrigação, de forma a obter rigidez adequada ao intercurso sexual.

Características:

- Composta por um par de hastes confeccionadas em silicone grau médico;
- Alma composta por filamentos de prata que proporciona maleabilidade e rigidez mecânica para a prótese;
- O corpo de silicone possui dureza maior junto à base, de forma a manter sustentação;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO AJUSTE
94187	9,0 mm	155 a 245 mm
94188	9,5 mm	155 a 245 mm
94189	10 mm	155 a 245 mm
94190	11 mm	155 a 245 mm
94191	12 mm	155 a 245 mm

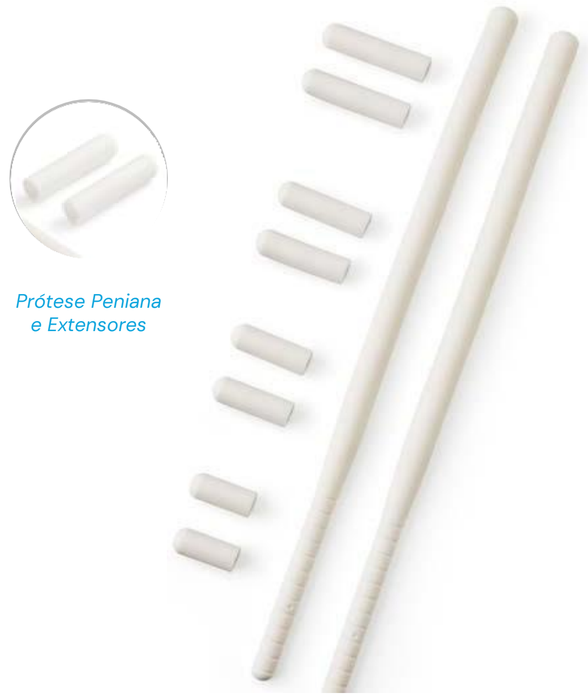

Prótese Peniana e Extensores

Nº Registro: 80020550032
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-021
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

TUBO HIPOSPADIA

Foi desenvolvido para auxiliar em cirurgias reparadoras de hipospadias, epispadias e outras más formações da uretra onde a mesma, ao invés de se fechar na extremidade da glande, fecha-se na parte inferior ou superior do pênis.

Também para qualquer outra deficiência uretral que requeira o uso de um cateter por período mais prolongado. O tratamento com Tubo Hipospadia Medicone visa conformar a nova uretra e a drenagem dos fluídos corpóreos visando a normalidade das características estéticas e funcionais do pênis e da uretra.

Características:

- Fabricado em silicone;
- Consiste em um cateter vazado em uma das extremidades para drenagem de fluidos corporais;
- Dispõe de ponteira que evita lesões vesicais no paciente;
- Dispõe de anel para fixação;
- Produto esterilizado em ETO (óxido de etileno).



Anel de Fixação

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
94712	TUBO PARA HIPOSPADIA 06 FR - 300 MM - MEDICONE
94713	TUBO PARA HIPOSPADIA 08 FR - 300 MM - MEDICONE
94714	TUBO PARA HIPOSPADIA 10 FR - 300 MM - MEDICONE
94715	TUBO PARA HIPOSPADIA 12 FR - 300 MM - MEDICONE
94719	TUBO PARA HIPOSPADIA 06 FR - 450 MM - MEDICONE
94720	TUBO PARA HIPOSPADIA 08 FR - 450 MM - MEDICONE
94721	TUBO PARA HIPOSPADIA 10 FR - 450 MM - MEDICONE
94722	TUBO PARA HIPOSPADIA 12 FR - 450 MM - MEDICONE

Nº Registro: 80020550048
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-007
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/

MODELADOR VESICAL

O Modelador Vesical Medicone é constituído por um balão interligado ao um conector por meio de um tubo.

Há uma membrana, que se sobrepõem ao tubo, em que uma de suas extremidades tem formato cônico para facilitar a remoção do Modelador Vesical Medicone após o tempo determinado de uso.

Características:

- O Modelador Vesical é constituído por um balão, um tubo, um conector e uma capa. Todos os componentes em silicone grau médico.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

CÓDIGO	MODELO
94725	Modelador Vesical 100 mL MV-100
94726	Modelador Vesical 270 mL MV-270



Modelador Vesical

Nº Registro: 80020550050
Referências: Instrução de Uso (IFU) e FT-MED-039
Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/



Medicone

Inovando para a Saúde

NOVEMBRO/2026 – VERSÃO 2.0

Medicone Projetos e Soluções para a Indústria e a Saúde Ltda
Av. das Indústrias, nº 1585 - Distrito Industrial - Cachoeirinha - Rio Grande do Sul, 94930-230
CNPJ: 94.304.672/0001-34 / **Inscrição Estadual:** 1770109630
Indústria Brasileira
E-mail: sac@medicone.com.br

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica S/A